

Patient

--

Applicateur :

Informations

- ☐ Fiche de mesures
- ☐ Moulage avec fiche de mesures
- ☐ Photos profil/face avec fiche de mesures
- ☐ Scan (.stl, .obj, .cpv) pour la 3D (.rpx, .rxp, .stl avec les tracés/découpes

Identification :

• Sexe : Âge : Poids : Taille :

Date des mesures :

- ## Fesses

- ☐ Plates ☐ Normales ☐ Fortes



Ventre

- ☐
- Plat
- ☐
- Normal
- ☐
- Bombé
- ☐
- Bombé ++


Poitrine

- ☐
- Faible
- ☐
- Moyenne
- ☐
- Forte
- ☐
- Tombante

Découpes :
Postérieur Antérieur

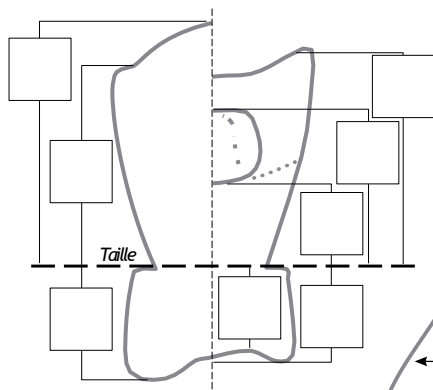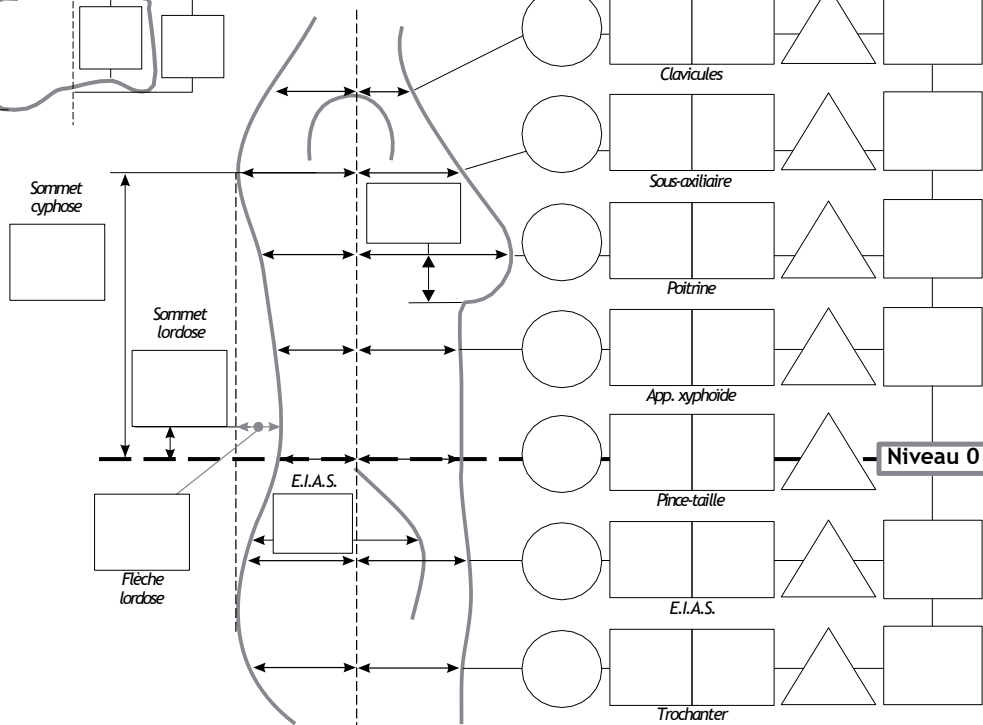

Indiquer plan des
découpes + renforts
et ouvertures :

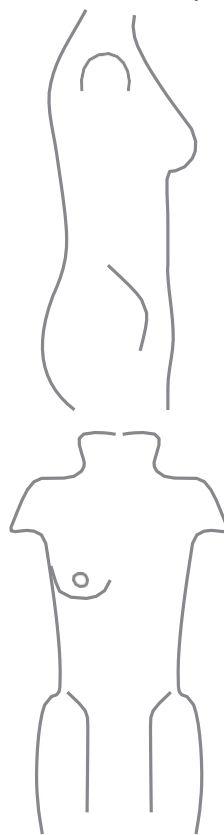

- N° d'appareil :
- Opérateur :

- Réf. JANTON production :



Les mesures indiquées seront strictement respectées. Nous nous réservons le droit de vous recontacter en cas de mesures incohérentes et/ou manquantes.

168 Z.A. des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex (France)
02.41.50.50.91 - cfao@janton-solutions.com - janton-solutions.com



FICHE DE MESURES

Corset - ORTHESE



Commande

- ☐ Rectification ([fiche de mesures obligatoire](#))
- ☐ Fraisage Ou ☐ Impression 3D
- ☐ Thermoformage ☐ Finition
- ☐ Finition

Ouverture

- ☐ Monovalve antérieur
- ☐ Monovalve postérieur
- ☐ Bivalve latéral (thermoformage uniquement)
- ☐ Autre (préciser la découpe sur le schéma au recto) : _____

Impression 3D

Nouveau

Hauteur de corset et fabrication

PP blanc cassé :

- ☐ TR59 Corset lombaire
- ☐ TR49 Corset thoraco-lombaire

Type de corset

- ☐ Maintien (Thermoformage ou 3D)
- ☐ Correction (Thermoformage uniquement)
- ☐ Urgence (Thermoformage)

Thermoformage

Hauteur de corset et fabrication

- ☐ TR79 Corselet lombaire
- ☐ TR59 Corset lombaire
- ☐ TR49 Corset thoraco-lombaire
- ☐ TR39 Corset claviculaire thoraco-lombaire
- ☐ Autre : _____

Matière thermoformage	
Épaisseur	
Couleur/transfert	

Matière garnissage	
Épaisseur	
Couleur	

Options

- ☐ Renforts mousse (thermoformés) ou inclus (3D) (préciser l'emplacement sur le schéma au recto)
- ☐ Thermocollage mousse/plastique (Thermoformage uniquement)
- ☐ Non thermocollé (thermoformage uniquement)

Finitions

Sous-patte	Cocher ci-dessous	Couleur	Sangles Velcros	Largeur	Couleur	Quantité
PE 1 mm		Transparent	PVC			
Mousse perforée 2 mm		Blanc	PU souple			
PU souple		Blanc/Noir				

Observations

.....

.....

.....

.....